

Formulaire de commande - Barre Overdenture avec "Copy-Mill" seulement

[Un seul cas par bon de commande]

IDENTIFICATION


SAP Client: _____
 # d'équipement: _____
 # de restauration: _____
 Contact: _____
 E-mail: _____
 Téléphone: _____

! Merci de remplir tous les champs textes ci-dessous

Dentiste: _____
 Denturologiste: _____
 Patient: _____
 Laboratoire: _____

INFORMATION DU CAS

POSITIONNEMENT

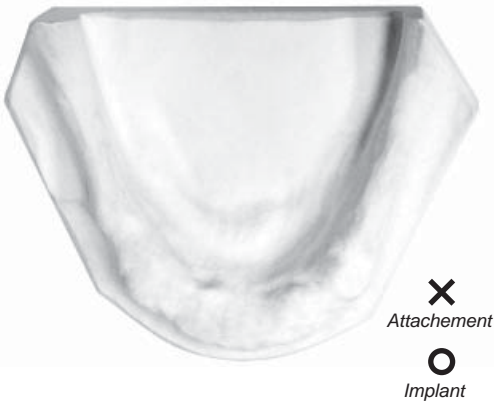

IMPORTANT

Inclure les éléments suivants dans votre **envoi**:

- Modèle - S.V.P. n'inclure que les éléments mentionnés ci-haut. Par exemple, éviter d'inclure l'articulateur.
- Maquette de résine*
- Gencive amovible (optionnel) - N'utilisez que des analogues neufs ou en très bon état.
- Autres : _____ - S.V.P. désinfectez tout le matériel.

* Veuillez-vous assurer que la maquette soit parfaitement fidèle à vos besoins, car toute imperfection sera reproduite dans le résultat final.


SYSTÈMES D'IMPLANT

Les barres overdenture basées sur des plateformes d'implant autres que Nobel Biocare sont fournies uniquement par des services de laboratoire et sous prescription d'un professionnel dentaire qualifié, pour un patient spécifique. Les produits livrés via des services de laboratoire sont couverts par une garantie de 5 ans. L'envoi de ce formulaire de commande confirme l'acceptation de ces conditions.

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nobel Biocare | <input type="checkbox"/> Astra Tech® | <input type="checkbox"/> BioHorizons® |
| <input type="checkbox"/> Biomet 3i™ | <input type="checkbox"/> Camlog® | <input type="checkbox"/> Curasan |
| <input type="checkbox"/> Dentsply® | <input type="checkbox"/> Innova | <input type="checkbox"/> MIS |
| <input type="checkbox"/> Semados® | <input type="checkbox"/> Steri-Oss® | <input type="checkbox"/> Straumann® |
| <input type="checkbox"/> Zimmer Dental® | <input type="checkbox"/> Autres: _____ | |

INSTRUCTIONS DE POLISSAGE

Indiquez les zones à polir :

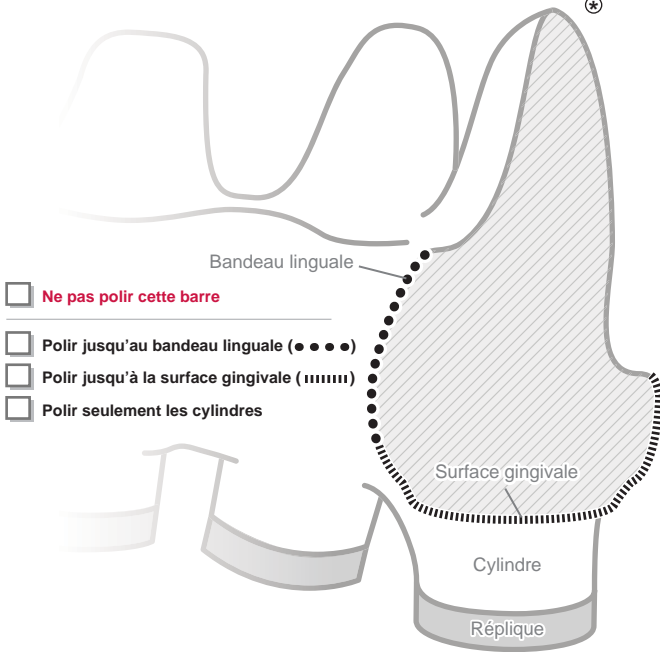

- Ne pas polir cette barre
- Polir jusqu'au bandeau linguale (●●●●●)
- Polir jusqu'à la surface gingivale (|||||)
- Polir seulement les cylindres

* La forme de ce dessin est à titre indicatif seulement; votre "Copy-Mill" peut avoir une forme différente.

IMPORTANT

! Des frais de design s'appliquent, communiquez avec votre représentant des ventes pour plus de détails.

COMMENTAIRES

Biocad est une marque déposée de Biocad GmbH & Co. KG | Dabco® et Dabco® sont des marques déposées de Conferences-Mécaniques SA, Loox® est une marque déposée de Züst Anchor, Inc | Anchor, M3 est une marque déposée de Synco-Dental | ACE est une marque déposée de ACE Surgical Supply Co., Inc. | Astra Tech® est une marque déposée de Astra Tech Group | Black Dental Implants est une marque déposée de Black Dental Implants LLC | BioHorizons® est une marque déposée de BioHorizons Inc | Straumann® est une marque déposée de Institut Straumann AG | 300 est une marque déposée de Biomet Group | Camlog® est une marque déposée de Camlog Biotechnologies Group | Curasan est une marque déposée de Curasan AG | Dentsply® est une marque déposée de Dentsply Frident Group | Zimmer Dental® est une marque déposée de Zimmer Dental Group | Innova est une marque déposée de Sybron Implant Solutions | MIS est une marque déposée de MIS Implant Technologies Ltd | Semados® est une marque déposée de BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG